

检测报告

报告编号 A2230496942102C04

第 1 页 共 7 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水（比对检测）

报告用途 自行监测

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 4028268B82

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07

版本/版次: 1.2

报告说明

报告编号 A2230496942102C04

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005


检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

编制：



签发：



审核：



签发人姓名：

李莉莉

采样日期：

2024 年 02 月 26 日

签发日期：

2024/03/07

检测日期：

2024 年 02 月 26~27 日

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07

版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2230496942102C04 第 3 页共 7 页

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 120.376761° 北纬 33.214017°）

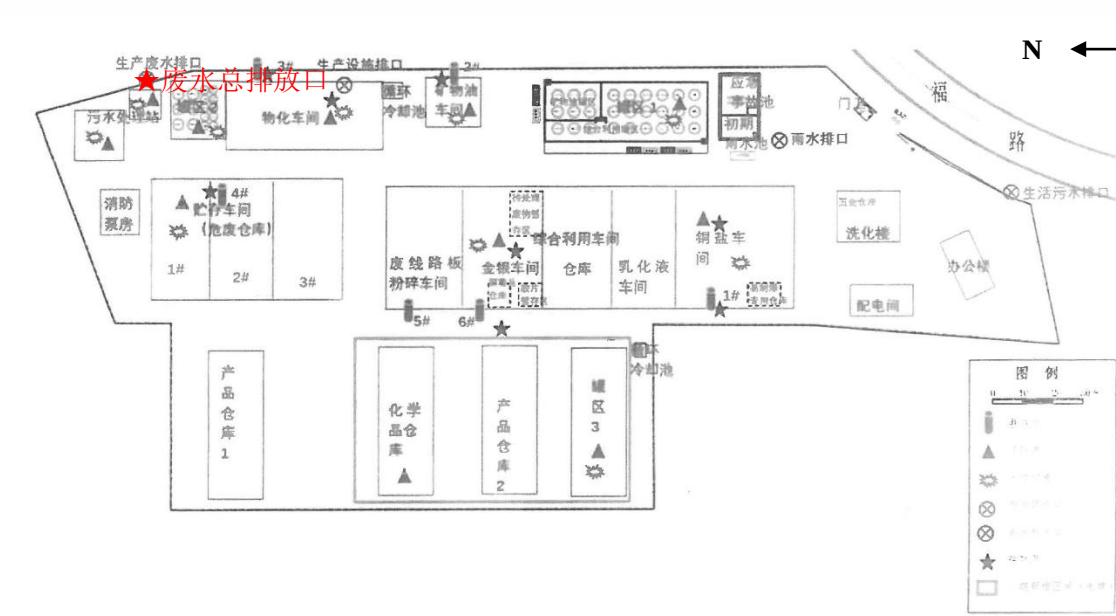

监测点位示意图

说明：★废水采样点

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次：1.2

检 测 结 果

报告编号 A2230496942102C04 第 4 页共 7 页

一、评价依据

- (1) HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
- (2) HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技术规范
- (3) HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）
- (4) HJ 355-2019 水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）运行技术规范

二、评价标准

仪器类型	指标限值		
NH ₃ -N 水质 自动分析仪	准确度	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品	± 10%
	实际水样 比对	实际水样氨氮<2mg/L (用浓度为 1.5mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试)	± 0.3mg/L
		实际水样氨氮≥2mg/L	± 15%

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次： 1.2

检 测 结 果

报告编号 A2230496942102C04 第 5 页共 7 页

三、检测结果

排污企业名称	江苏好山水环保科技有限公司		现场监测日期	2024 年 02 月 26 日		
测点名称	废水总排放口		分析日期	2024 年 02 月 26~27 日		
工况	50%		样品类型	废水		
样品状态	无色、无味、透明、无浮油		工作量程	0~100mg/L		
测试项目	氨氮		采样人员	朱宜能、干加丽		
实际水样测试						
样品编号	采样时间	水质分析仪 测定值 (mg/L)	实验室测定值 (mg/L)	相对 误差	标准 限值	结果 评定
HAQ13004S501	10:45	14.34	12.6	13.8%	±15%	合格
HAQ13004S502	11:24	14.36	12.5	14.9%		合格
HAQ13004S503	11:56	14.11	12.8	10.2%		合格

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2230496942102C04 第 6 页共 7 页

接上表:

质控样品测定						
质控样品 编号及批号	质控样浓度 (mg/L)	测试时间	自动仪器 测试结果 (mg/L)	标准限值	比对结果	结果 评定
BD-NH ₃ -N 20240222-02	50	09:44	49.59	±10%	-0.820%	合格
技术说明						
类别	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限	
试验仪器	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光 光度计（UV）	T6 新世纪（五 联）	TTE20232669	0.025 mg/L	
自动仪器	纳氏试剂 分光光度法	氨氮在线 分析仪	NH ₃ -N-2000	CC2117B0638	0.01mg/L	
比对 结果	以上结果表明本次江苏好山水环保科技有限公司废水总排放口氨氮的在线分析 比对结果达到指标要求。					

注：采样点位、采样频次由客户指定。

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次： 1.2

检 测 结 果

报告编号 A2230496942102C04 第 7 页共 7 页

本次检测的依据:

产品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L

注：此报告的数据结果仅供委托方科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的，不具有对社会的证明作用。（征得客户同意）

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次： 1.2