

检测报告

报告编号 A2230496942102C05

第 1 页 共 6 页

委托单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位 江苏好山水环保科技有限公司

受检单位地址 盐城市大丰区经济开发区电子信息产业园永福路 35 号

样品类型 废水（比对检测）

报告用途 自行监测

淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

检验检测专用章

No. 4028268B82

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07

版本/版次: 1.2

报告说明

报告编号 A2230496942102C05

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005


检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

编制：



签发：



审核：



签发人姓名：

李莉莉

采样日期：

2024 年 02 月 26 日

签发日期：

2024/03/07

检测日期：

2024 年 02 月 26~27 日

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07

版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2230496942102C05 第 3 页共 6 页

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 120.376761° 北纬 33.214017°）

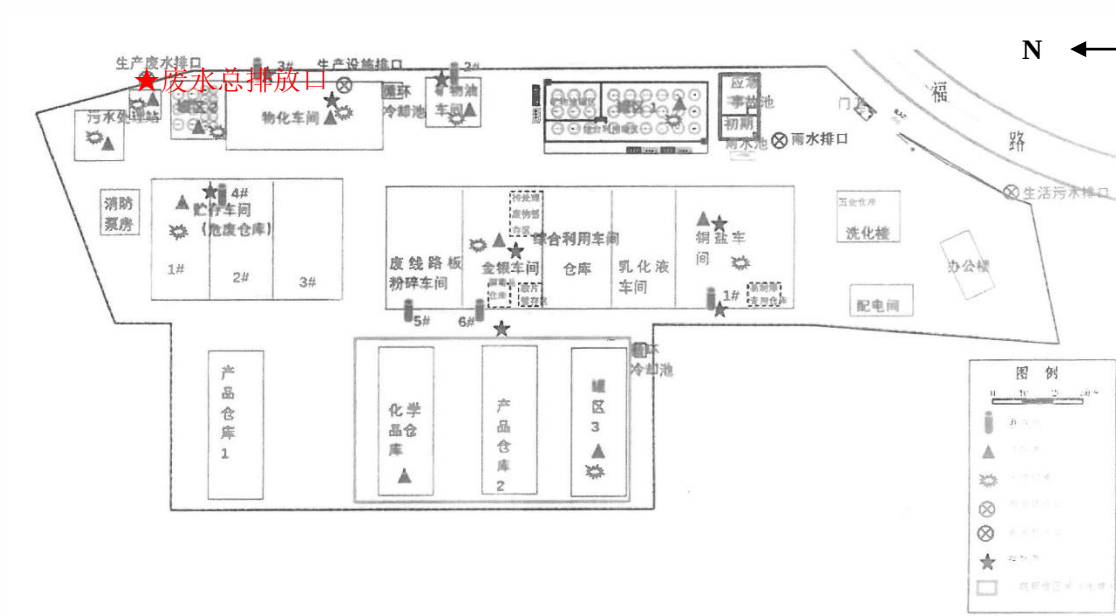

监测点位示意图

说明：★废水采样点

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2230496942102C05 第 4 页共 6 页

检测结果

排污企业名称	江苏好山水环保科技有限公司		现场监测日期	2024 年 02 月 26 日
测点名称	废水总排放口		分析日期	2024 年 02 月 26~27 日
工况	50%		样品类型	废水
样品状态	无色、无味、透明、无浮油		工作量程	0~0.5mg/L
测试项目	易释放氰化物		采样人员	朱宜能、干加丽
实际水样测试				
样品编号	采样时间	水质分析仪测定值（mg/L）		实验室测定值（mg/L）
HAQ13004S501	10:45	3.526×10 ⁻³		4×10 ⁻³ L
HAQ13004S502	11:24	4.811×10 ⁻³		4×10 ⁻³ L
HAQ13004S503	11:56	3.000×10 ⁻³		4×10 ⁻³ L

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2230496942102C05 第 5 页共 6 页

接上表:

质控样品测定					
质控样品 编号及批号		质控样浓度 (mg/L)	测试时间	自动仪器测试结果 (mg/L)	
BD-水中氰 20240222-01		0.25	09:44	0.250760	
技术说明					
类别	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
试验仪器	水质 氰化物的 测定 容量法和 分光光度法 HJ 484-2009 方法 2 异烟酸- 吡唑啉酮分光 光度法	紫外可见分光 光度计（UV）	UV-7504	TTE20171231	4×10 ⁻³ mg/L
自动仪器	过硫酸钾氧化 间苯二酚分光 光度法	氰化物水质自动在 线监测仪	C310	640000019009	0.000001 mg/L

注：1.采样点位、采样频次由客户指定。
2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2230496942102C05 第 6 页共 6 页

本次检测的依据:

产品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	易释放氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	4×10 ⁻³ mg/L

注：此报告的数据结果仅供委托方科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的，不具有对社会的证明作用。（征得客户同意）

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTI LD-HACEDD-0034-F07 版本/版次： 1.2